



SAH/HSJB
PROC. N°
FL. N°
RUBRICA

Volta Redonda, 07 de Maio de 2025.

Análise das Propostas – Processo VR-02.051 – 4740/2024

De: Assessoria Técnica

Para: Licitação/HSJB

Assunto: Avaliação das propostas com as especificações técnicas para aquisição de leitos de recuperação pós anestésica e maca de transferência de forma a atender ao novo Centro Cirúrgico com do Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista. Processo VR-02.051 – 4740/2024, pregão N° 90033/2025.

Item 01: Leito de recuperação pós anestésica RPA

Após avaliação da proposta da empresa Vital Scheffer concluímos que a mesma não atende as especificações técnicas solicitadas no edital para os Leitos de Recuperação Pós Anestésica RPA.

No edital:

Acionamento através de 4 motores com controle de mão e membrana nas grades laterais.

Na proposta:

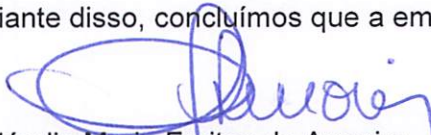
Acionamento através de 3 motores com controle de mão.

Diante do exposto, o modelo ofertado **não atende** ao solicitado. Assim, sugerimos dar prosseguimento com a proposta do segundo colocado.

Item 02: Maca de Transferência Inox Para Obeso

Após avaliação da proposta da empresa Hospitalare Móveis & Equipamentos concluímos que a mesma **atende** as especificações técnicas solicitadas no edital para a Maca de Transferência Inox para Obeso.

Diante disso, concluímos que a empresa é considerada vencedora do certame.


Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica
Assessora Técnica
HSJB