



SAH/HSJB
PROC. Nº
FL. Nº
RUBRICA

Volta Redonda, 25 de Abril de 2025.

Análise das Propostas – Processo VR-02.051 – 3579/2024

De: Assessoria Técnica

Para: Licitação/HSJB

Assunto: Avaliação das propostas com as especificações técnicas para aquisição de equipamentos hospitalares de forma a atender ao novo Centro Cirúrgico com aumento de demandas do Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista. Processo VR-02.051 – 3579/2024, pregão Nº 90117/2024.

Item 2:


Após avaliação da proposta da empresa Shell-Life concluímos que a mesma não atende as especificações técnicas solicitadas no edital para o Foco Cirúrgico de teto para sala robótica.

No edital foi solicitado:

“As cúpulas deverão conter os controles: regulador de intensidade, liga/desliga, aviso luminoso/sonoro para falhas de iluminação, sendo possível seu uso através de painel de fácil higienização.”

No manual:

O painel do equipamento fica localizado no braço do equipamento e não na cúpula conforme solicitado.

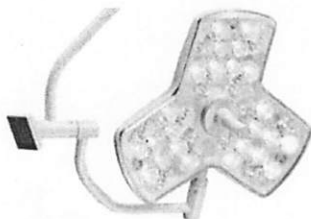

Além disso, conforme informado no Termo de Referência é importante que os equipamentos sejam padronizados, visando a economia na compra de peças e manutenção, facilidade de usabilidade e



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. Nº
FL. Nº
RUBRICA

padronização das salas do centro cirúrgico, comprando dessa forma o equipamento da marca Drager.

Preservando a lisura do processo e a garantia da segurança do paciente, sugerimos seguir com o quarto colocado do processo.

Itens 03:

Após avaliação da proposta da empresa Medifarr concluímos que a mesma não atende as especificações técnicas solicitadas no edital para as Mesas Cirúrgicas do Hospital.

No edital:

Mesa Cirúrgica eletro-hidráulica para utilização em diversas angulações e posicionamentos para atender procedimentos cirúrgicos de baixa, média e alta complexidade.

Na proposta:

A mesas ofertadas apresentam funcionamento apenas elétrico.

No edital:

Possuir comprimento mínimo de 2000mm e largura de pelo menos 540mm (sem trilhos/régua).

Na proposta:

Possuir comprimento mínimo de 2000mm e largura de 500mm (sem trilhos/régua).

Diante do exposto, sugerimos seguir com o segundo colocado.

Item 04:

No edital:

Mesa Cirúrgica eletro-hidráulica para utilização em diversas angulações e posicionamentos para atender procedimentos cirúrgicos de baixa, média e alta complexidade.

Na proposta:

A mesas ofertadas apresentam funcionamento apenas elétrico.

No edital:

Baterias com capacidade média para 60 procedimentos cirúrgicos

Na proposta:

Baterias internas recarregáveis com capacidade para pelo menos 20 procedimentos cirúrgicos ou 05 (cinco) dias sem recarga.

No edital:

Controle remoto com display de LCD colorido, com demonstração dos movimentos da mesa e ângulos.

**SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR**

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ

CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300

e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. Nº
FL. Nº
RUBRICA

Na proposta:

Controle remoto com LEDS que demonstram os movimentos da mesa e ângulos.

Informamos também que de acordo com esclarecimento datado de 31/01/2015 item 3.26 constante no processo se define que o suporte de coluna é o articulado radiotransparente do tipo Wilson, porém essa informação não consta na proposta

Diante do exposto, sugerimos seguir com o segundo colocado.


Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica
Assessora Técnica
HSJB